



NUTZUNG DIGITALER TOOLS IN DER PHYSIOTHERAPIE





GALA-Verbundpartner

MedAix



EINFÜHRUNG IN DIE PRAXIS

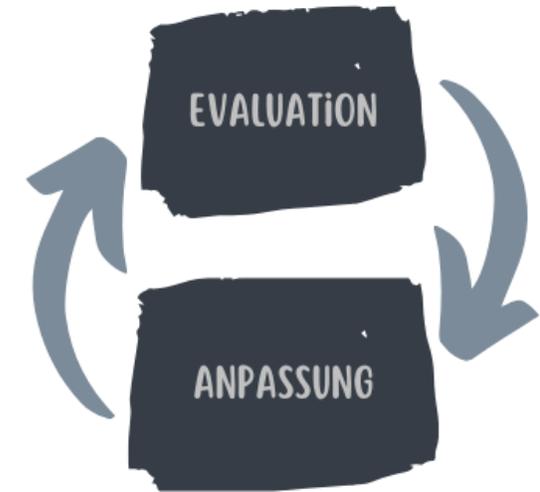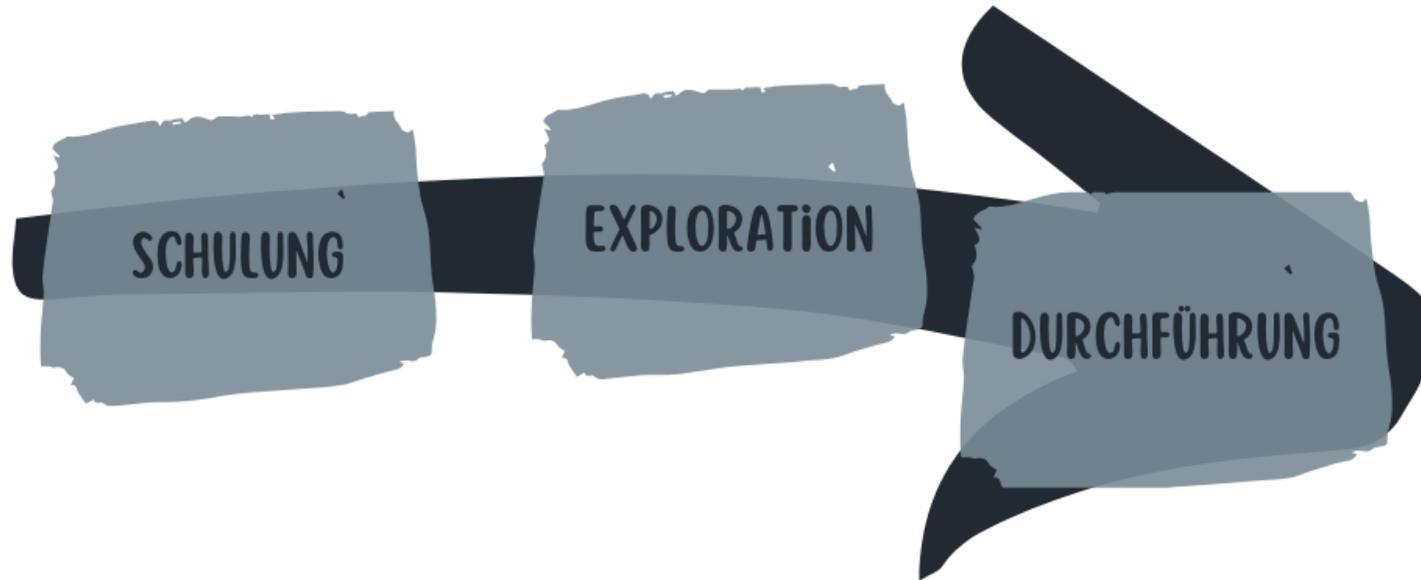


GALA-Verbundpartner

MedAix



BEISPIELE AUS DER PRAXIS

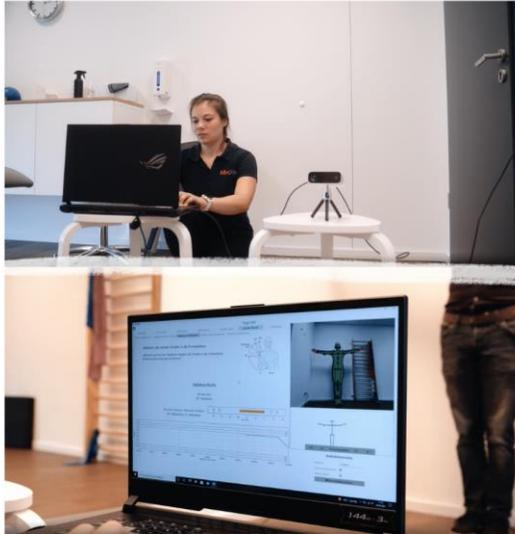

Weiterentwicklung einer Infrarot-Tiefenkamera zur Erfassung der Range-of-Motion

- + • objektive Messungen möglich
- • Messung nicht valide genug

Messung der Muskelaktivität mittels EMG

- + • objektive Messung der Muskelspannung möglich
- Gerät bereits validiert
- • Materialverbrauch



GALA-Verbundpartner

MedAix